



中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0176.8—1997

脐 带 剪

Umbilical cord scissors

1997-08-27 发布

1998-01-01 实施

国家医药管理局 发布

YY/T 0176.8—1997

前 言

本标准除型式、尺寸、闭合力、剪切性能外均符合 YY/T 0176—94《医用剪通用技术条件》。

本标准调整了头端尺寸的极限偏差等级。

本标准从生效之日起,代替 GB 3342—89。

本标准由全国外科器械标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位:上海手术器械厂。

本标准主要起草人:周培瑜。

中华人民共和国医药行业标准

脐 带 剪

YY/T 0176.8—1997

Umbilical cord scissors

1 范围

本标准规定了脐带剪(以下简称剪刀)的产品分类和技术要求。

本标准适用于脐带剪。该产品供产科剪切婴儿脐带用。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

YY/T 0173.2—94 手术器械 球面圆柱沉头轴螺钉

YY/T 0173.8—94 手术器械 蛋形指圈

YY/T 0176—94 医用剪通用技术条件

3 产品分类

3.1 剪刀的型式、基本尺寸和极限偏差应符合图1的规定。

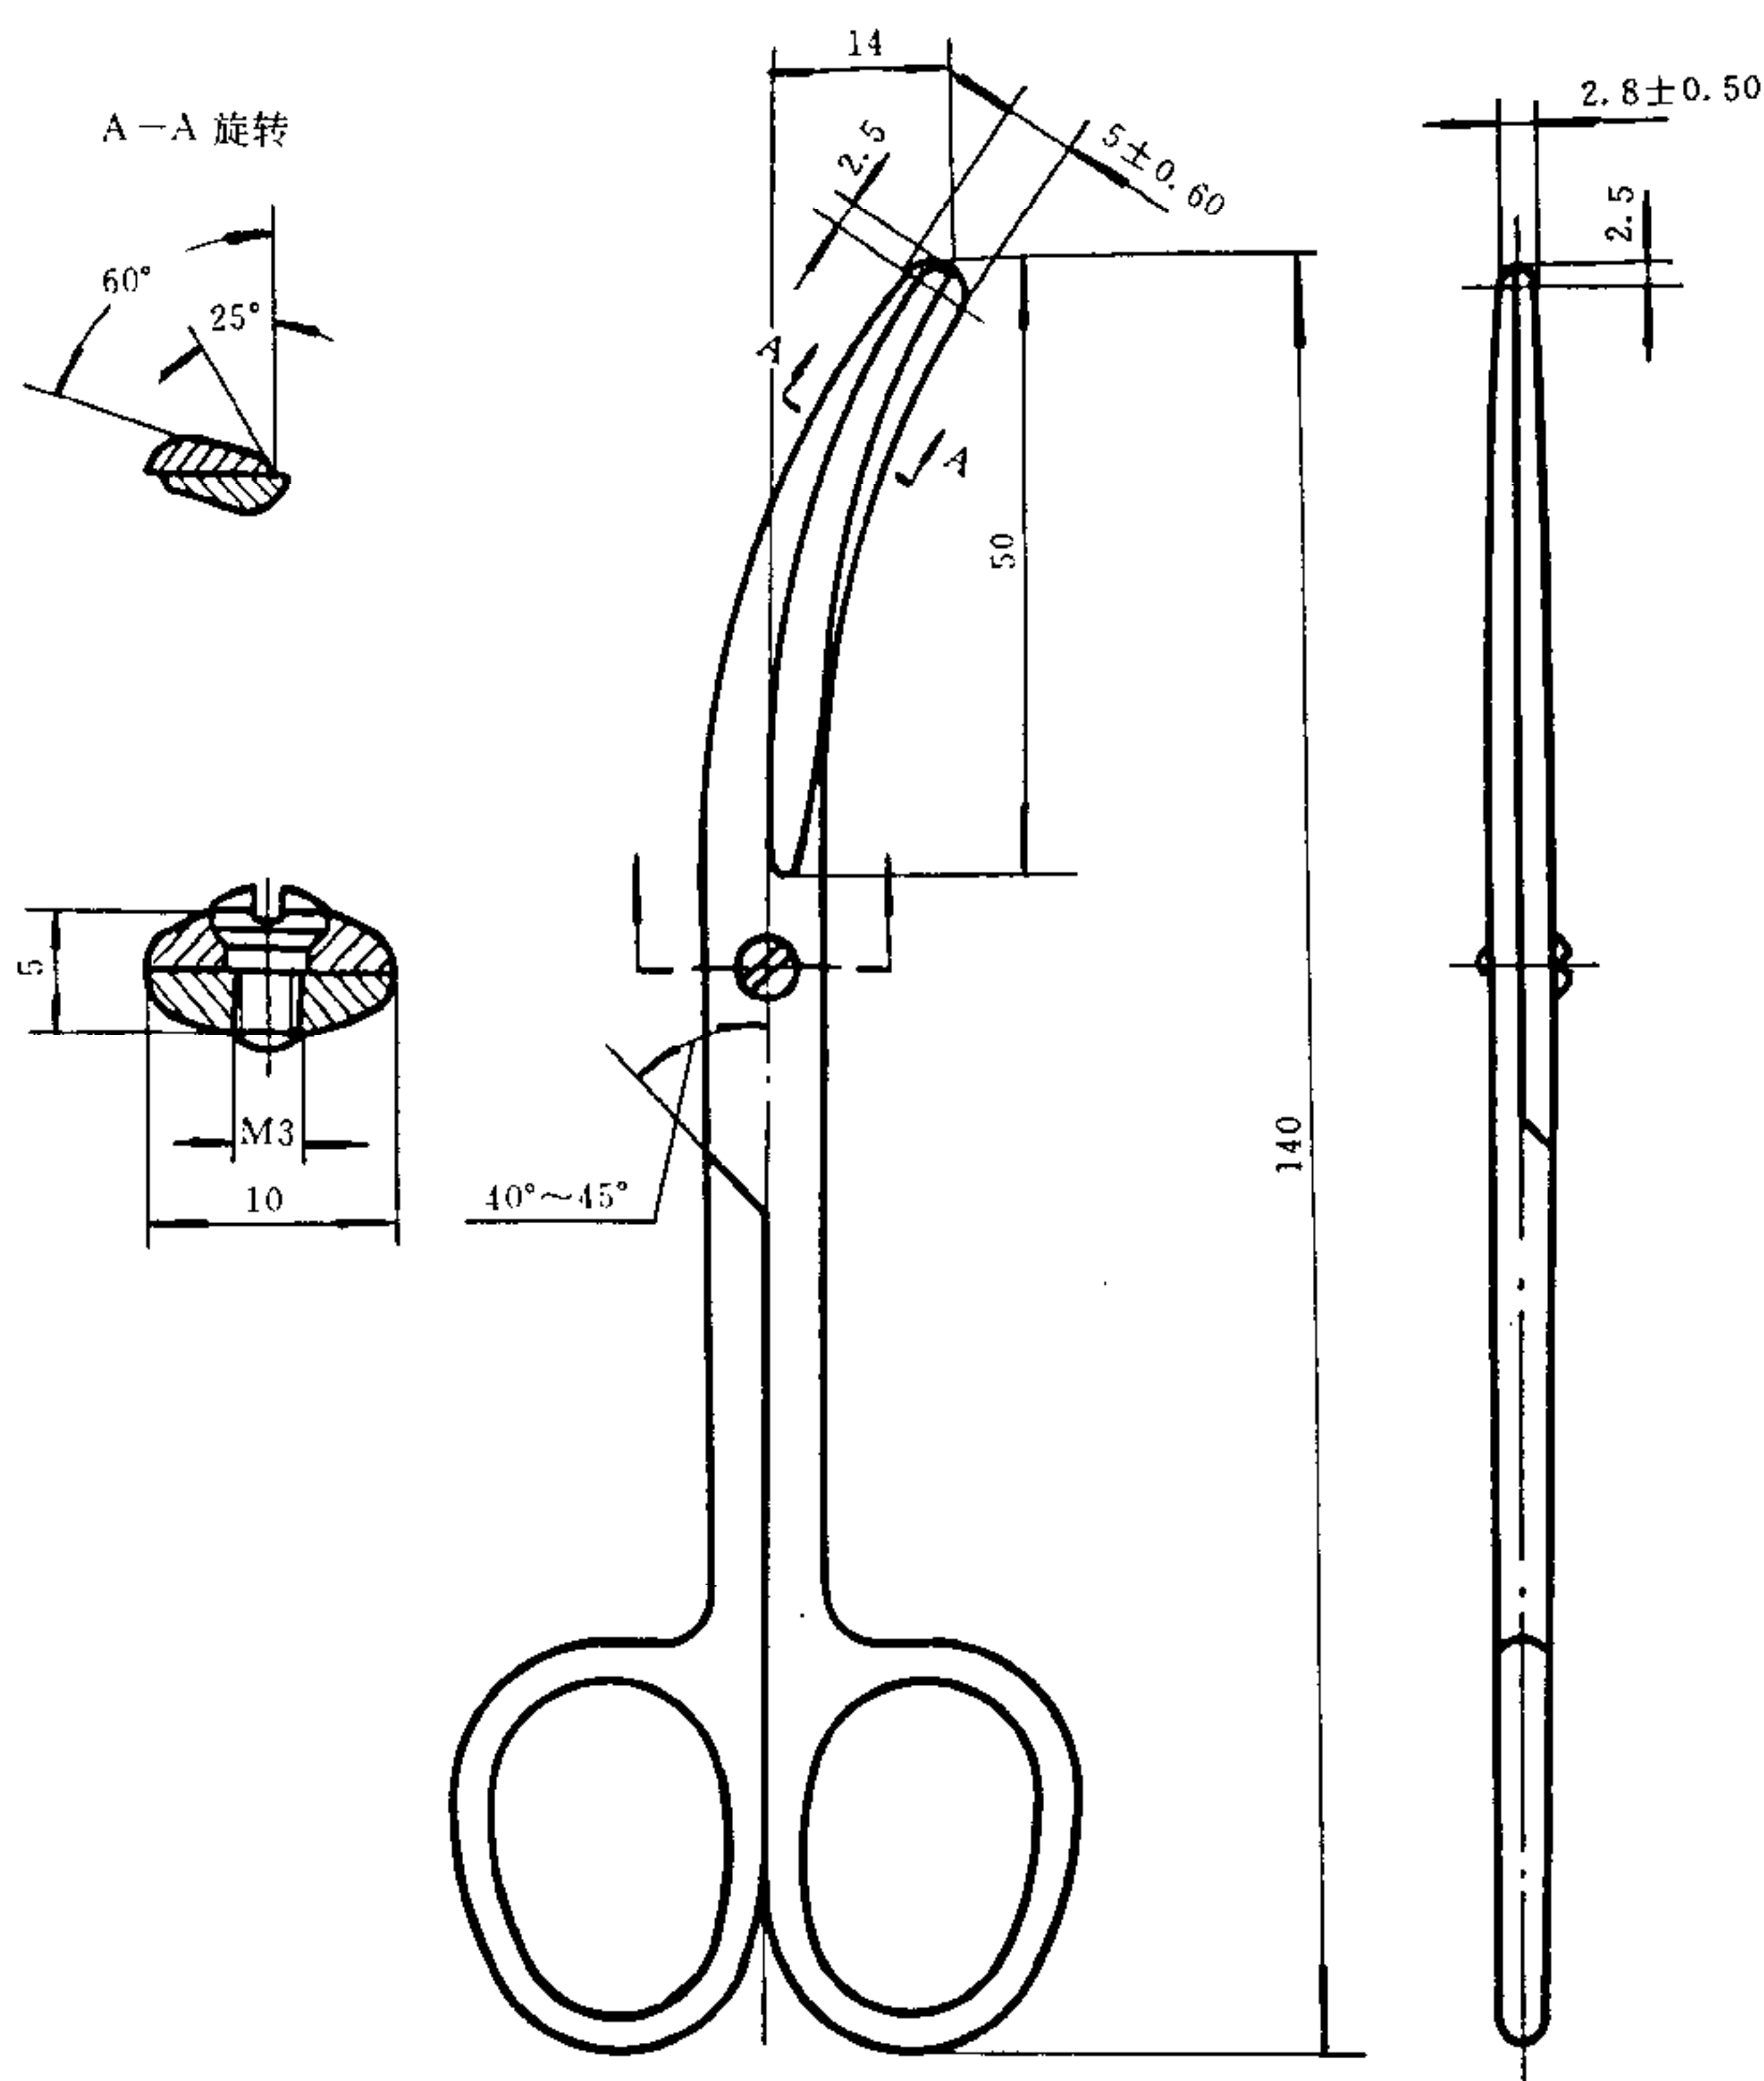


图1 脐带剪

3.2 剪刀的蛋形指圈应符合 YY/T 0173.8 中 25×32 的规定。

4 技术要求

4.1 剪刀应的空剪闭合力不大于 6.5 N。

4.2 剪刀刀片距头端三分之二处开始试剪四层 21 支纱布或五层 42 支纱布,应切口整齐,不应有撕裂和拉出纤维现象。

4.3 剪刀的其余技术要求应符合 YY/T 0176 中的规定。

5 其他

剪刀的试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存应符合 YY/T 0176 中的规定。

中华人民共和国医药
行 业 标 准
脐 带 剪
YY/T 0176.8—1997

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 5 千字
1998 年 3 月第一版 1998 年 3 月第一次印刷
印数 1—1 000

*

*

标 目 330--68